Date	Nature des modifications	Ind

Coupe A-A

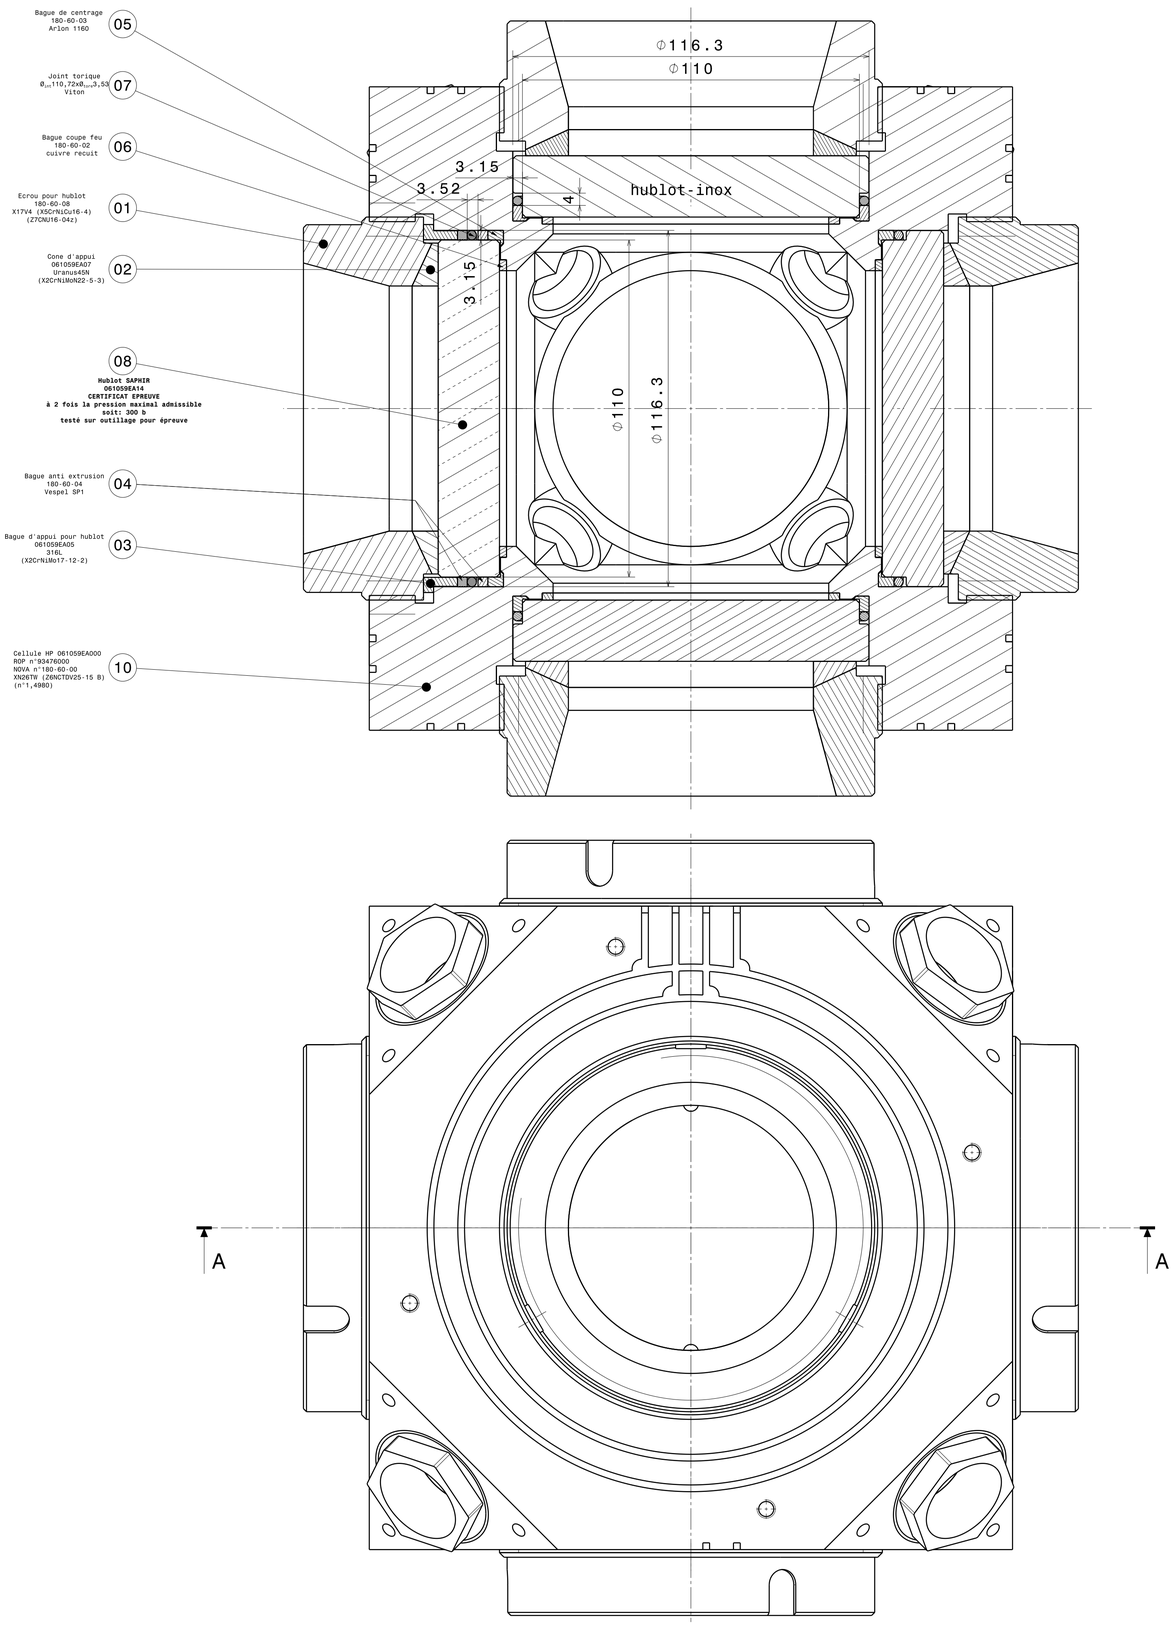

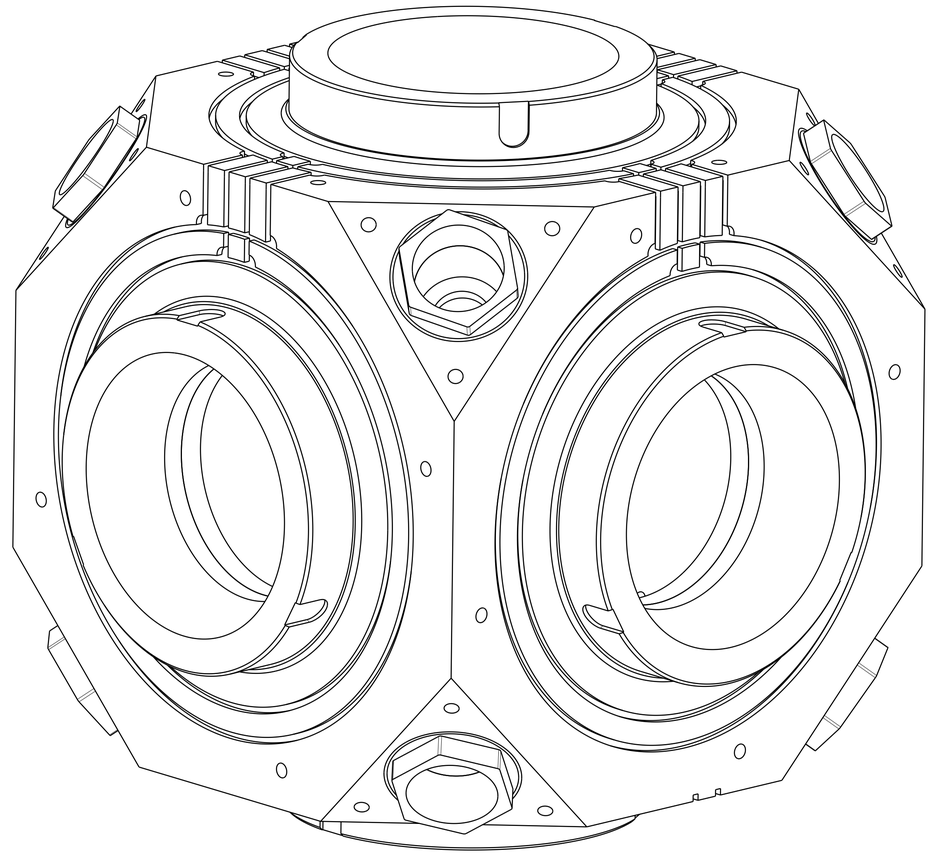

Graver sur le corps de l'appareil:

-LE N° DE LA PIECE
-LES CONDITIONS D'UTILISATIONS.

CONDITIONS D'UTILISATIONS:

-Pression d'utilisation: 150 bar.
-Pression maximale admissible:165 bar.
-Pression d'épreuve : 225 bars et 300bar pour le hublot rep08
-Température d'utilisation : 200°C.
-Température admissible mini:ambiante - max:250°C
-Volume: 1L
-P.V.: 165
-Catégorie de risque: II
-Soumis à l'épreuve: OUI
-Marquage CE: OUI
-Groupe de fluides: G1
-Nature des produits utilisés: Hydrocarbures.

RSP-G1-II

Ce plan est la propriété de l' I.F.P. Il ne pourra être divulgué sans son autorisation.

DIRECTION MECANIQUE APPLIQUEE	DEPARTEMENT GENIE MECANIQUE	R041

IMPLANTATION HUBLOT SAPHIR

SUR CELLULE NOVA N°180-60-01 & ROP N°93476001

TOLERANCES GENERALES						ECHELLE	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
Dimensions	Alesage	Arbre	Longueur	Filet	Angles	- 1:1 -	17/09/09	FAILLA	-
<30	+ 0.2 + 0	+ 0 - 0.2	± 0.1	6 H	± 15'	A1		061059EA100	
>30	H 13	h 13	Js 13	6 g					